

お客様各位

平成 27 年 8 月 19 日

15-30

インフォメーション

登録衛生検査所 臨床 宮崎

TEL0985-52-6688 FAX0985-52-8093

BNP(ヒト脳性Na利尿ペプチド)

所要日数短縮のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では皆様のご要望にお応えし、また医療の進歩に寄与すべく絶えず検査領域の拡大に努めておりますが、このたび、表記検査項目の所要日数を短縮(当日報告可能)させて頂くこととなりましたので、ご案内申し上げます。

尚、その他、検査容器、参考基準値、単位等の変更はございません。

何卒、ご利用、ご用命の程よろしくお願い申し上げます。

謹 白

記

● 所要日数短縮項目:

■ BNP(ヒト脳性Na利尿ペプチド)

◆ 変更開始期日:平成 27 年 9 月 1 日(火)受付分より

※詳細につきましては裏面をご参照ください


ご不明な点は弊社担当までお申し付け下さい

■ BNP(ヒト脳性Na利尿ポリペプチド)

◆ 検査内容:

	新検査内容	旧検査内容
項目名称	BNP	同左
検査方法	CLIA法	CLEIA法
採取容器	EDTA2Na 2/5/7mL管 (容器毎の容量を厳守して下さい)	同左
検体必要量	血漿 0.5ml	同左
保存方法	採血後、冷蔵	同左
参考基準値	18.4 以下	同左
単位	pg/mL	同左
測定範囲	5.8 ~ 14510	2.1 ~ 希釈最終値
所要日数	1~2日 (当日中にFAXにて報告可能)	4~5日
測定装置	ARCHITECT i2000SR (ABBOTT)	システムルミパルスPresto II (富士レビオ)
備考	ご依頼のさいは、現状どおり、総合検査依頼書内【BNP】にチェック下さい	

◆ 相関図:

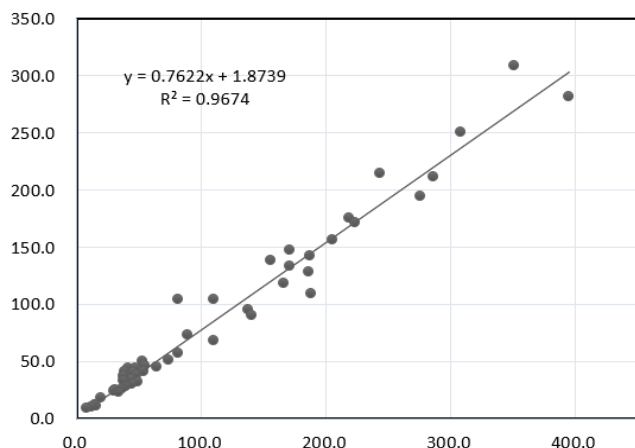

No.	新	旧	No.	新	旧
1	308.5	351.0	26	48.8	71.9
2	280.8	395.0	27	46.9	54.2
3	250.0	308.0	28	45.2	55.0
4	213.9	244.0	29	45.0	64.8
5	211.4	286.0	30	43.8	41.9
6	193.5	276.0	31	43.5	46.8
7	175.0	219.0	32	41.0	53.5
8	170.5	224.0	33	40.7	38.5
9	156.4	205.0	34	39.2	45.5
10	146.8	171.0	35	37.8	47.7
11	142.1	187.0	36	36.3	37.6
12	137.8	156.0	37	33.5	44.7
13	133.0	171.0	38	32.3	37.6
14	128.2	186.0	39	31.9	49.1
15	117.8	166.0	40	29.9	44.2
16	109.1	188.0	41	27.8	39.2
17	104.2	81.2	42	26.0	36.6
18	103.5	110.0	43	24.2	31.0
19	94.8	138.0	44	23.3	29.6
20	89.4	141.0	45	23.1	34.2
21	72.6	89.1	46	17.3	19.7
22	68.0	110.0	47	11.7	14.5
23	57.2	82.0	48	10.6	16.1
24	50.9	73.6	49	9.4	11.9
25	49.3	52.6	50	8.4	7.9

以上