

インフォメーション

登録衛生検査所 臨床 宮崎
TEL0985-52-6688 FAX0985-52-8093

検査内容変更項目のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご愛顧を賜り、有難く厚く御礼申し上げます。

この度、下記検査項目につきまして、検査内容を一部変更させて頂くこととなりましたので、ご案内申し上げます。

何卒、ご了承賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹 白

記

● 検査内容変更項目:

- 抗GAD抗体
- 可溶性IL-2レセプター(sIL-2R)
- TARC

◆ 変更開始期日:平成 27 年 12 月 17 日(木)受付分より

※詳細につきましては裏面をご参照ください

■ 抗GAD抗体


現試薬の販売中止に伴い、Non-RIA 試薬に変更させていただきます。新基準値はメーカー設定値です。

◆ 変更内容：

変更内容	新	旧
検査方法	ELISA 法	RIA 法
参考基準値 (単位)	5.0 未満 (U/mL)	1.5 未満 (U/mL)
報告範囲	5.0 未満 / 5.0 ~ 1990 / 2000 以上	0.3 未満 / 0.3 ~ 99900000
実施料 / 判断料	136 点 / 144 点 (生化Ⅱ検査)	同左

【参考文献】及川 洋一, 他: 医学と薬学 72 (9) : 1551~1560, 2015.

◆ 現法と新法の比較：

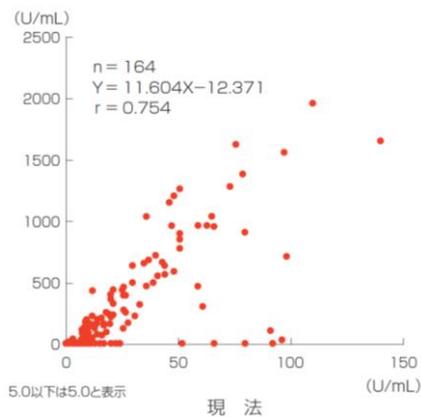

■ 可溶性IL-2レセプター (sIL-2R)



測定精度向上のため現試薬と同メーカーの試薬および全自動測定装置に変更させていただきます。これに伴い、検査方法および検体量等を変更させていただきます。なお、参考基準値等、その他、変更はございません。

◆ 変更内容：

変更内容	新	旧
検査方法	CLEIA 法	ELISA 法
検体量	血清 0.5mL	血清 0.4mL
報告範囲	50.0 未満 / 50.0 ~ 99900000	54.5 未満 / 54.5 ~ 99900000
実施料 / 判断料	460 点 / 144 点 (生化Ⅱ検査)	同左

【参考文献】丹部 絵梨, 他: 医療と検査機器・試薬 37 (5) : 649~657, 2014.

◆ 変更内容：

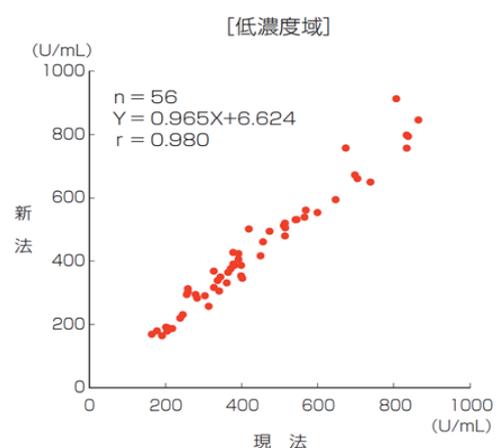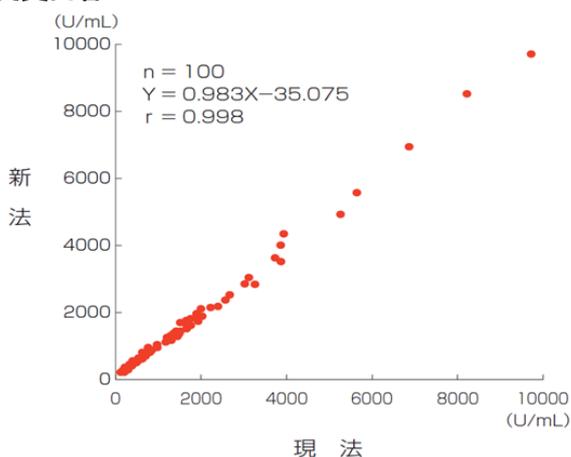

■ TARC

現試薬の製造中止に伴い、現試薬より測定レンジの広い測定試薬に変更させていただきます。併せて、検査方法を変更いたします。なお、参考基準値等、その他、変更はございません。

◆ 変更内容：

変更内容	新	旧
検査方法	CLEIA法	ELISA法
報告範囲	100未満 100~99990000	125未満 125~99990000
実施料／判断料	194点／144点（免疫学的検査）	同左

【参考文献】安江 智美, 他: アレルギーの臨床 34 (10) : 60~65, 2014.

◆ 現法と新法の比較：

